


Steviolglycoside in frischen Stevia Blättern

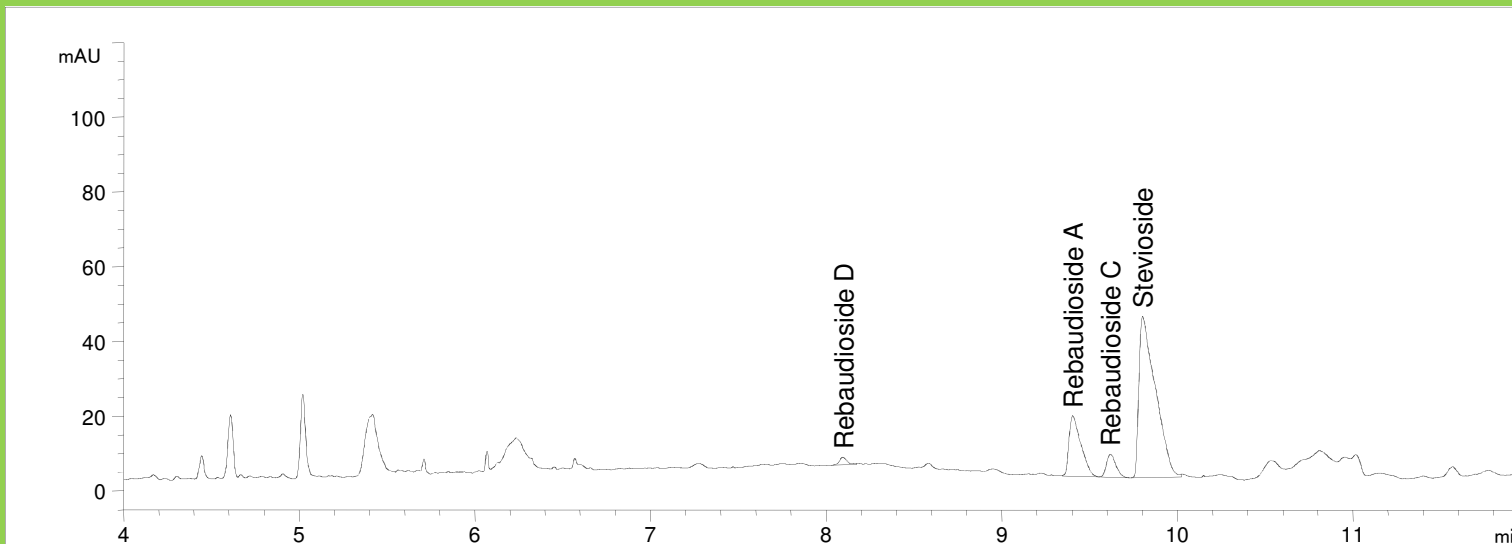

Trenntechnik: CGE

Elektrolyt: Borat / SDS / HPMC

Kapillare: fused silica, 50 µm ID,
Bubble Cell, 64 cm gesamt

Detektion: direkte UV, 200 nm

Bestimmung von: Rebaudioside D, Rebaudioside A, Rebaudioside C und Stevioside